


03

## 移动式3.0T肢端核磁共振成像系统

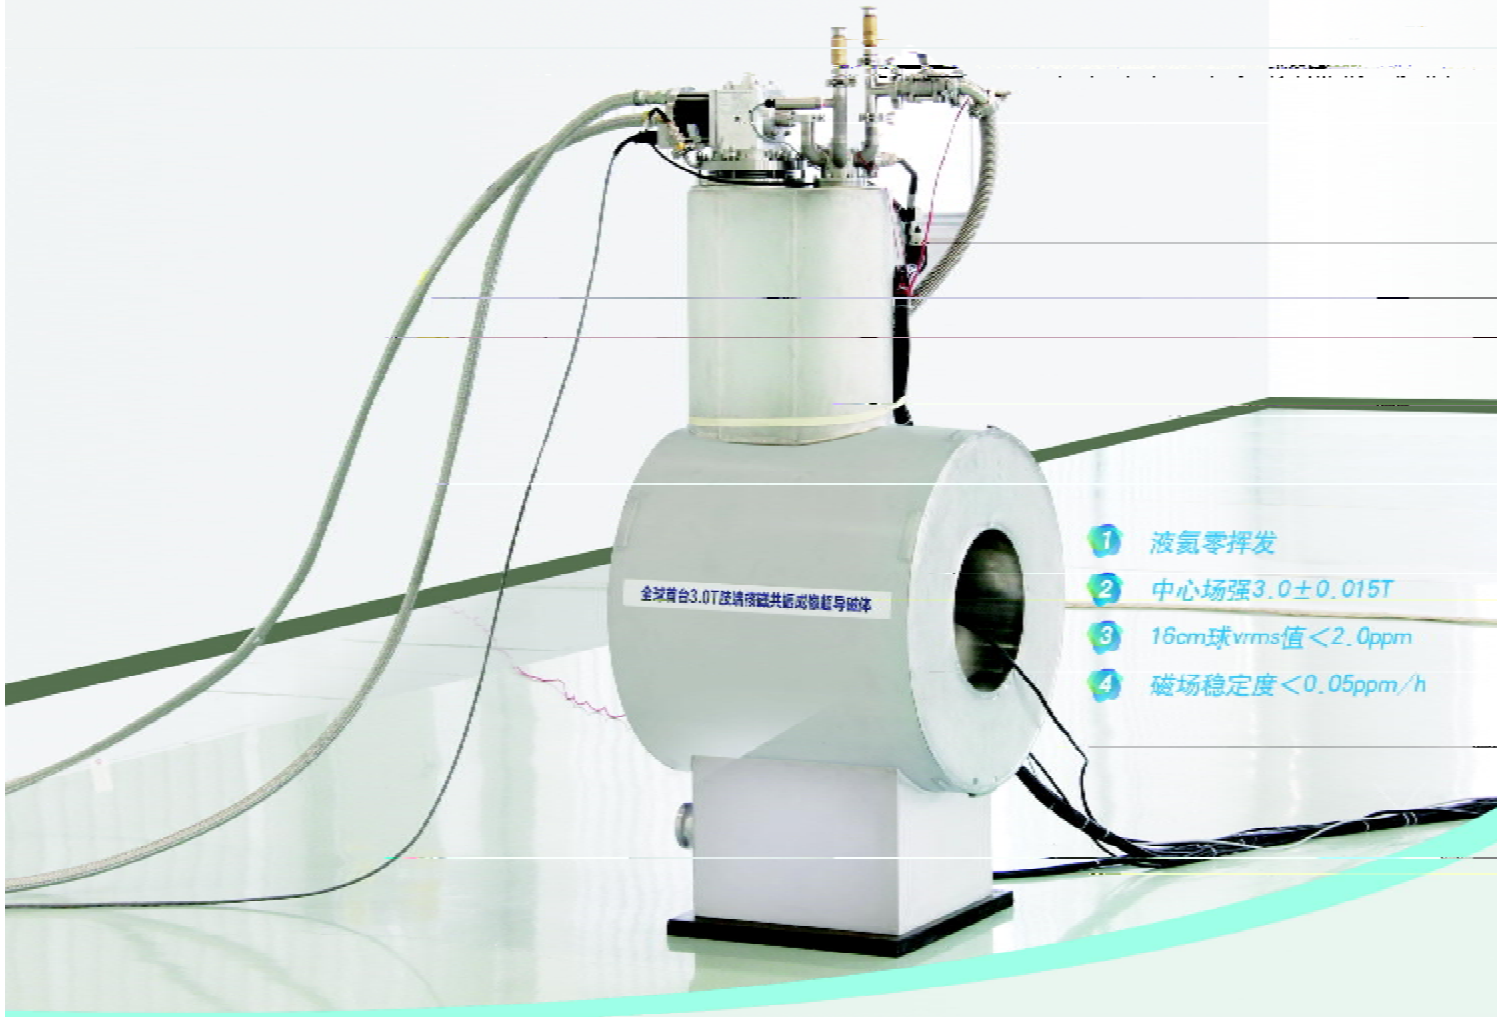


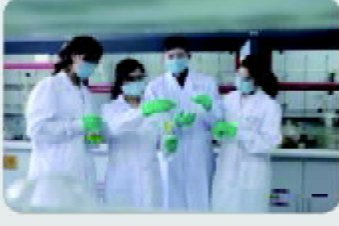

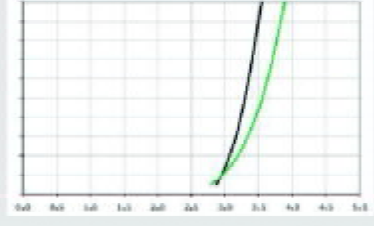


- 1 液氮零挥发
- 2 中心场强 $3.0 \pm 0.015T$
- 3 16cm球vrms值 $< 2.0ppm$
- 4 磁场稳定度 $< 0.05ppm/h$

### 移动式 3.0T 肢端核磁共振成像系统主要技术指标

E G F G	-
= F H I	a
= J H I	
= K	
L M N	
O	
O P Q	b
R	c c
S T U V	
W	
X Y W Z [ \	
W R ]	
# ^	# ^ def ef

### 移动式 3.0T 肢端 MRI 系统优势

 <p>移动医疗</p>	 <p>精准医疗</p>	 <p>分子影像</p>
 <p>科学研究</p>	 <p>互联网+手机APP</p>	 <p>扫描快速</p>